

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/42790)

چاپ

دوره چهل و هشتم تابستان 1403

G1 Results

HBV-DNA NAT.1


کد نمونه 1046	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------


(Excellent)	رنگ آبی: عملکرد عالی
(Acceptable)	رنگ سبز: عملکرد مطلوب
(Caution)	رنگ زرد: اخطار
(Warning)	رنگ نارنجی: اخطار شدید
(Rejected)	رنگ قرمز: مردود
(Out Of Range)	خارج از محدوده


Sample Number	Sample Code	Lab Result	G-Result (Log IU/mL)	G-Median	G-SD	Indicator
Sample1	1046					No Value
Sample2	2046	2625.00	3.42	3.75	0.65	
Sample3	3046	1146.00	3.06	3.84	0.60	
Sample4	4046	356.00	2.55	3.17	0.64	
Sample5	5046	0.00				


حرف G در کلمات G-SD و G-DI مخفف ژئومتریک (آماره هندسی) میباشد.


(/IACLD/UpFiles/Packages/C22G1A/1000.jpg)	(/IACLD/UpFiles/Packages/C22G1A/1000.jpg)	(/IACLD/UpFiles/Packages/C22G1A/1000.jpg)	(/IACLD/UpFiles/Packages/C22G1A/1000.jpg)	(/IACLD/UpFiles/Packages/C22G1A/1000.jpg)
---	---	---	---	---










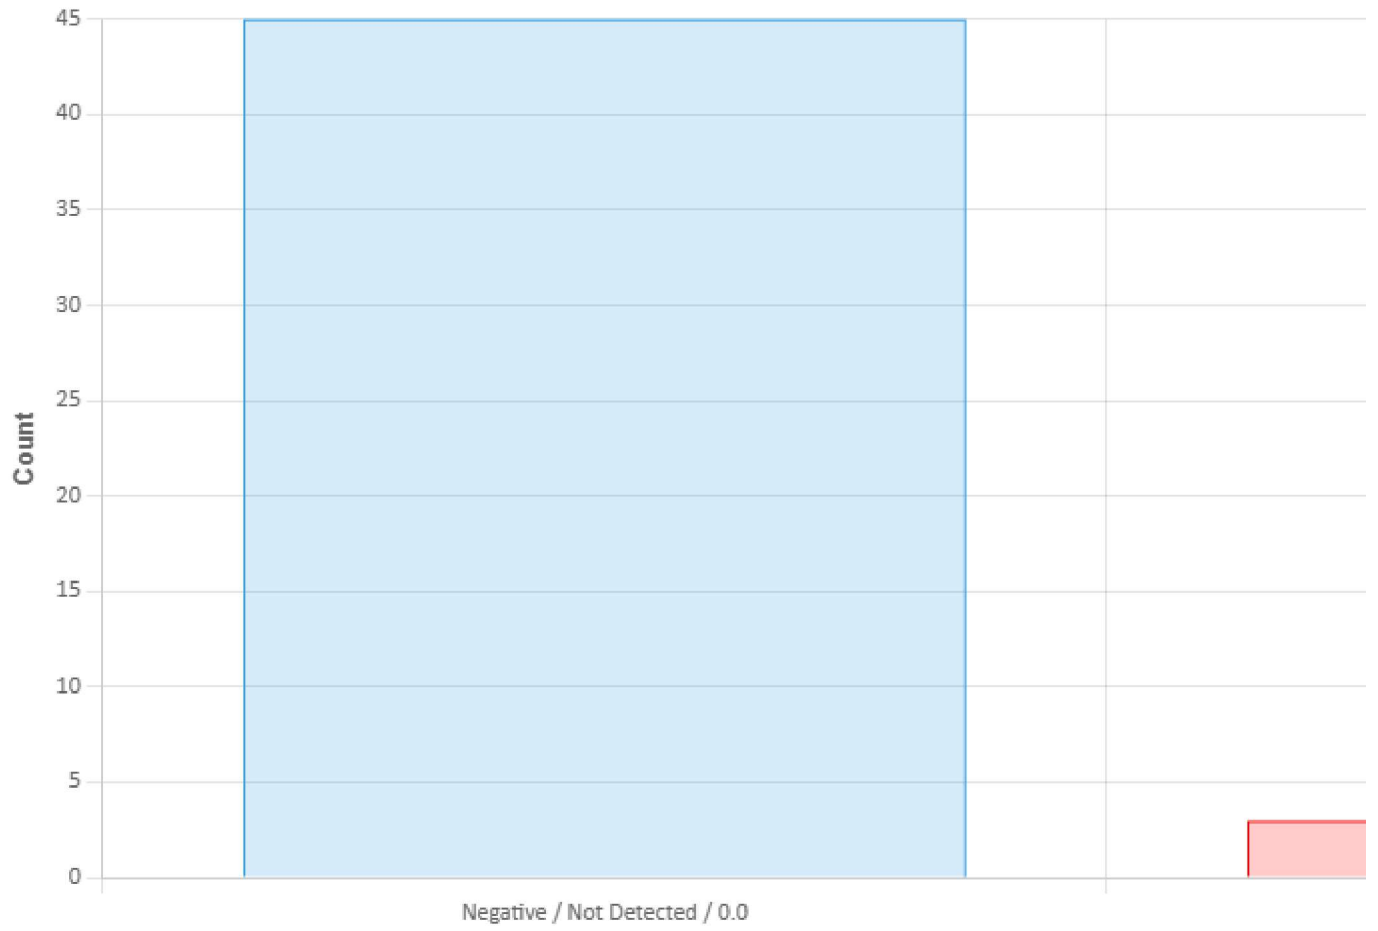



Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.